




PFA

DN	Trubka AISI 304			Příruba s drážkou	Přírubový svařenec			Otvory v trubce	Svar
	Vnější průměr D	Tloušťka S	Celková délka trubky L	Vnitřní průměr díry	Celková délka LC	Vnější rozteč výpalků LV	Rozměr výpalku A	4x díra na elektrody pro "PFA" (4xØE)	
10	20	2	192	21	194	84	21x76x5	11	a3
15	25	2	192	26	194	84	26x80x5	11	
20	28	2	192	29	194	84	29x80x5	12	
25	32	2	192	33	194	84	33x80x5	12	
32	40	2	192	41	194	84	41x100x5	15	
40	48,3	2	192	49,3	194	94	49,3x110x5	15	
50	60,3	2	192	61,3	194	94	61,3x115x5	15	
65	80	2	192	81	194	94	81x140x5	15	
80	85	2	192	86	194	94	86x150x5	15	a4
100	114,3	3	242	116,3	244	114	115,5x180x5	5,7	
125	139,7	3	242	141,7	244	144	141x210x5	5,7	
150	168,3	3	292	170,3	294	174	170,3x255x5	5,7	
200	219	3	342	221	344	184	221,5x310x5	5,7	
250	273	3	442	276	444	210	276x370x5	5,7	
300	323,9	3	492	327	494	265	327x440x5	5,7	

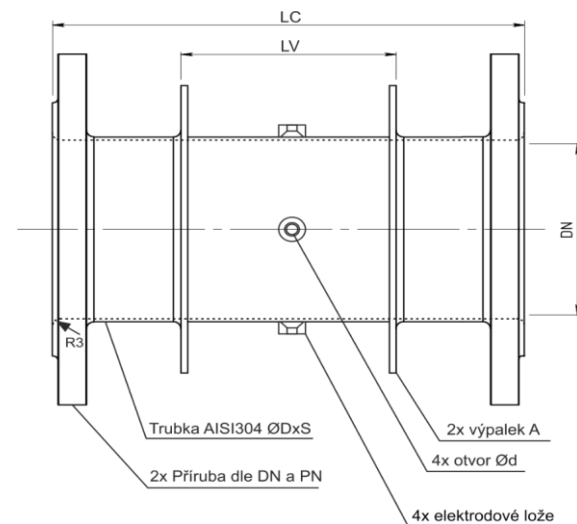

Celková délka svařence Lc může být v toleranci maximálně ±1mm

DN	Výstelka PFA	
	Vnitřní průměr D	Celková délka LP
10	10	200
15	13	200
20	18	200
25	22	200
32	30	200
40	36	200
50	47	200
65	65	200
80	73	200
100	96	250
125	124	250
150	146	300
200	194	350
250	249	450
300	296	500

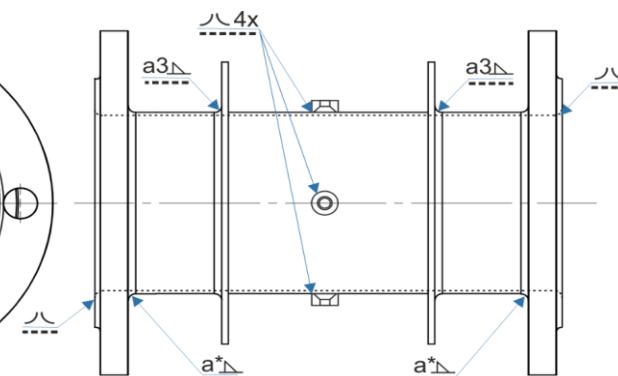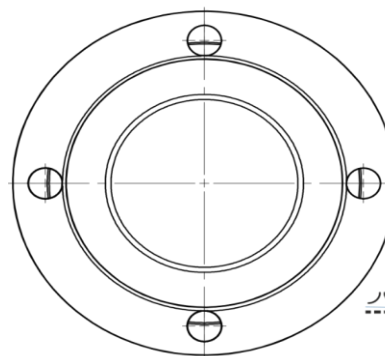

Svařenec v tlakové třídě do PN40 a max. teplotě 150°C.

POKUD NENÍ UVEDENO JINAK: JEDNOTKY JSOU V MILIMETRECH		ZÁKAZNÍK:		REVIZE ZÁKAZNÍKA	
		KONEČNÁ ÚPRAVA:		REVIZE INTERNÍ	
				3	
NAVRHL	JMÉNO	PODPIS	DATUM	KLAPKA	TELEFON
SCHVÁLIL	M.Maceček		29.1.2019		
POLOTOVAR:					
PLOCHA:		MATERIÁL:		NÁZEV:	
PROPRIETÁRNÍ A DŮVĚRNÉ INFORMACE OBSAŽENÉ V TOMTO VÝKRESU JSOU VLASTNICTVÍM COMAC CAL s.r.o. JAKÁKOVY REPRODUKCE ČÁSTI NEBO CELKU BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU COMAC CAL s.r.o. JE ZAKÁZÁNA.				Přírubový svařenec výstelka PFA	
HMOTNOST:		C. VÝKRESU		SESTAVA 12	
		MĚŘÍTKO:		NEUPRAVOVAT MĚŘÍTKO VÝKRESU	
		STAV:			
				LIST 1 Z 1 LISTŮ	